

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために◆


二酸化炭素測定器を活用しましょう

長引くコロナ対応ですが、
もうひと踏ん張り
がんばりましょう！



計測値は **1000 ppm** を保つようにしましょう

厚生労働省推奨基準

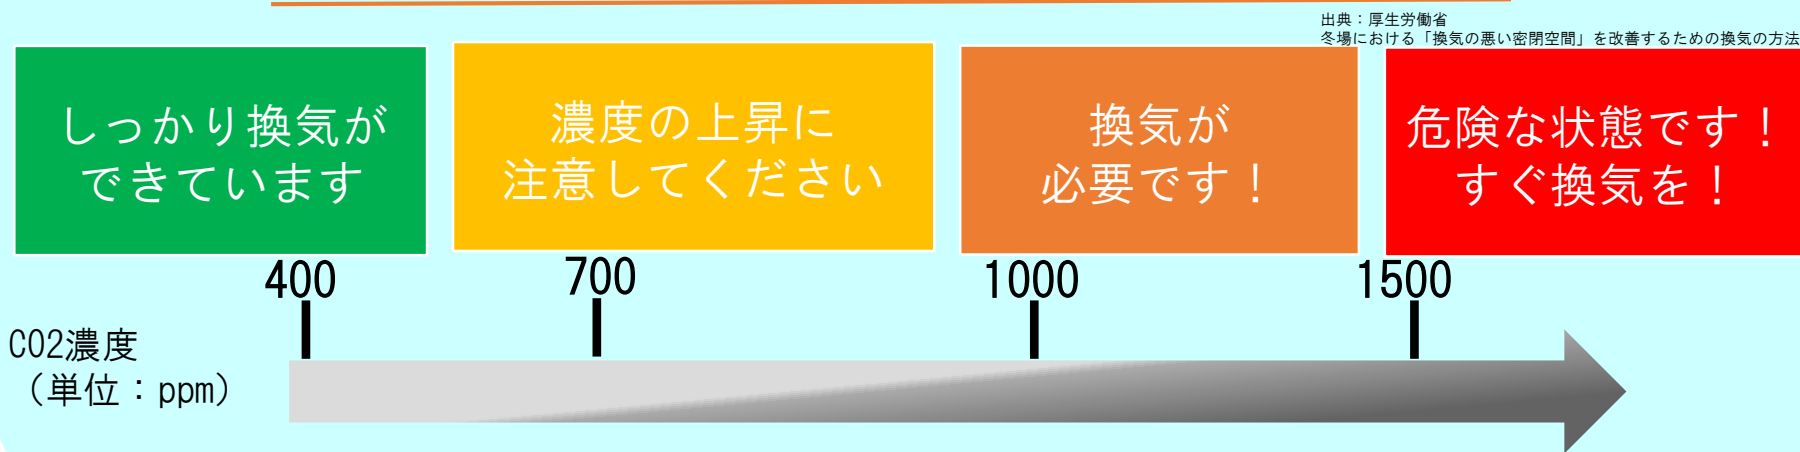

(注意) 精度管理のため、計測器は定期的にはリセットしてください。

濃度計を置く場所に注意！

出典：経済産業省・産業用ガス検知警報器工業会
二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン

●測定器の位置は ドア、窓、換気口から離れた場所 で 人から少なくとも50cm離れたところ にしましょう。

●会議や休憩室など、人が集まる場面で測定する ようにしましょう。